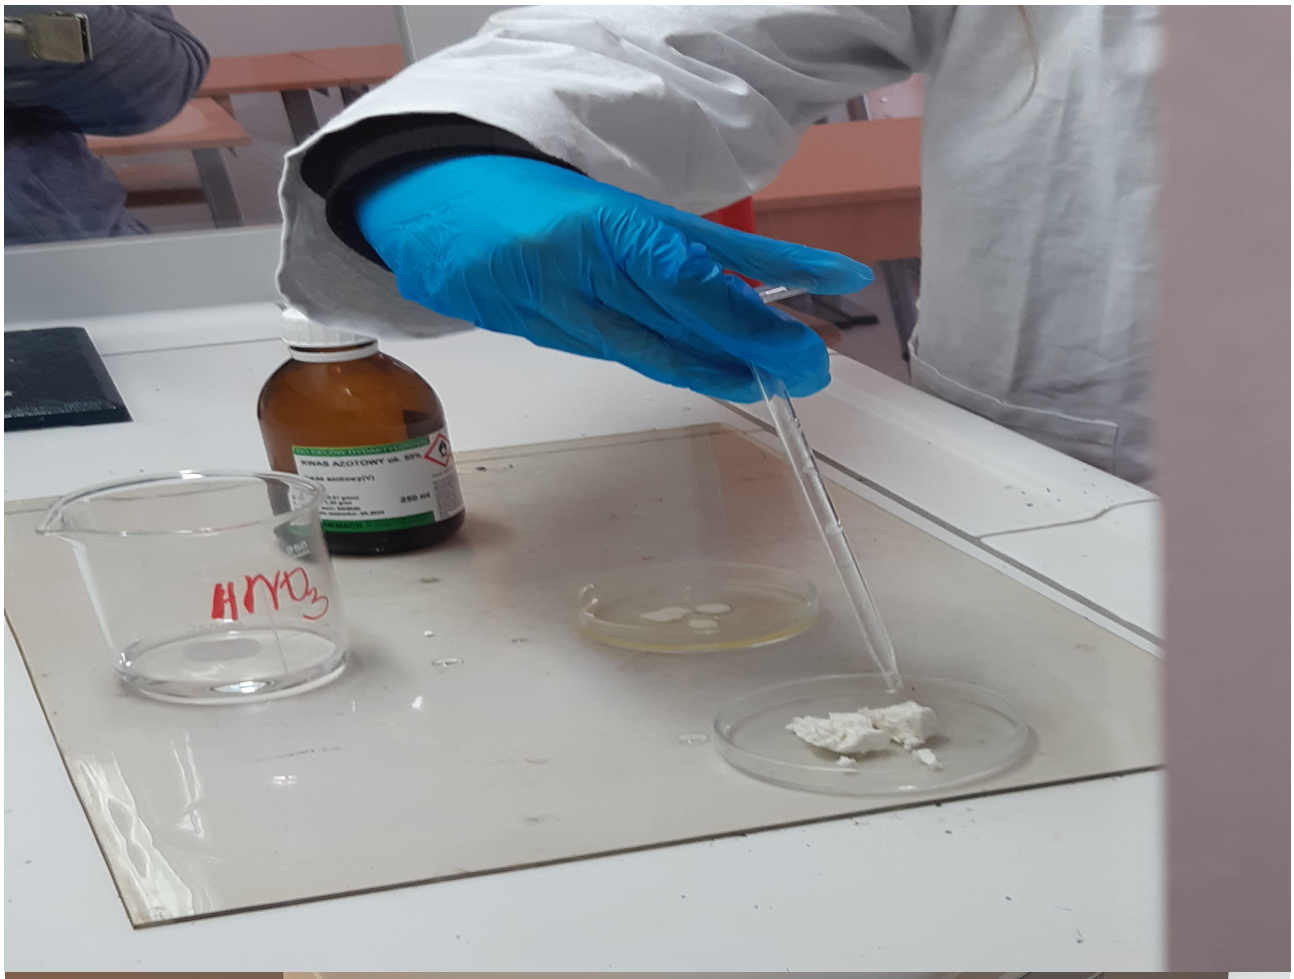

KWAS AZOTOWY ok. 65%
250 ml
HNO3





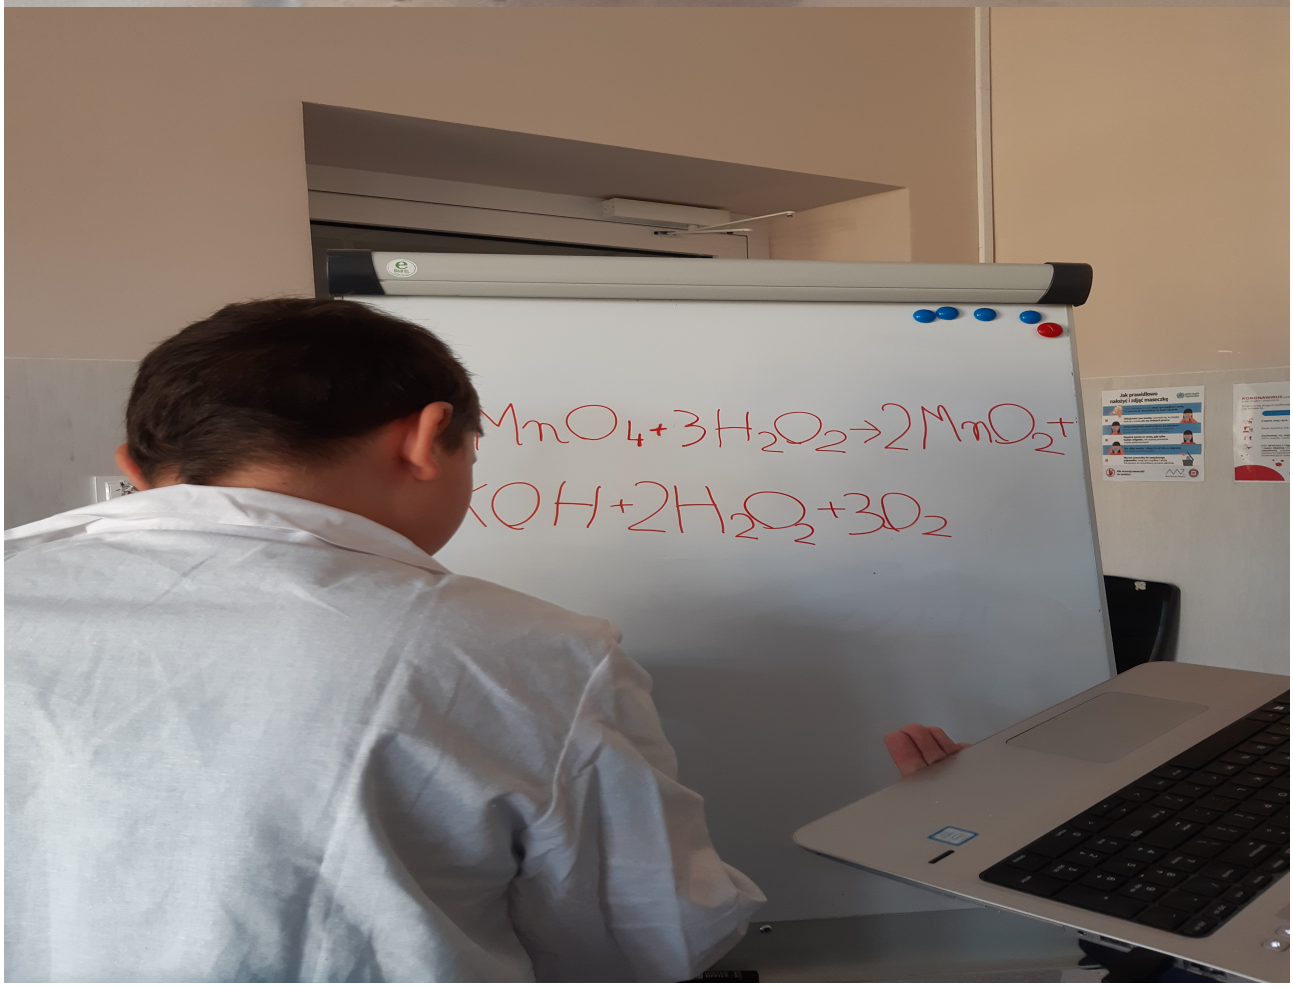

WENTYLATOR

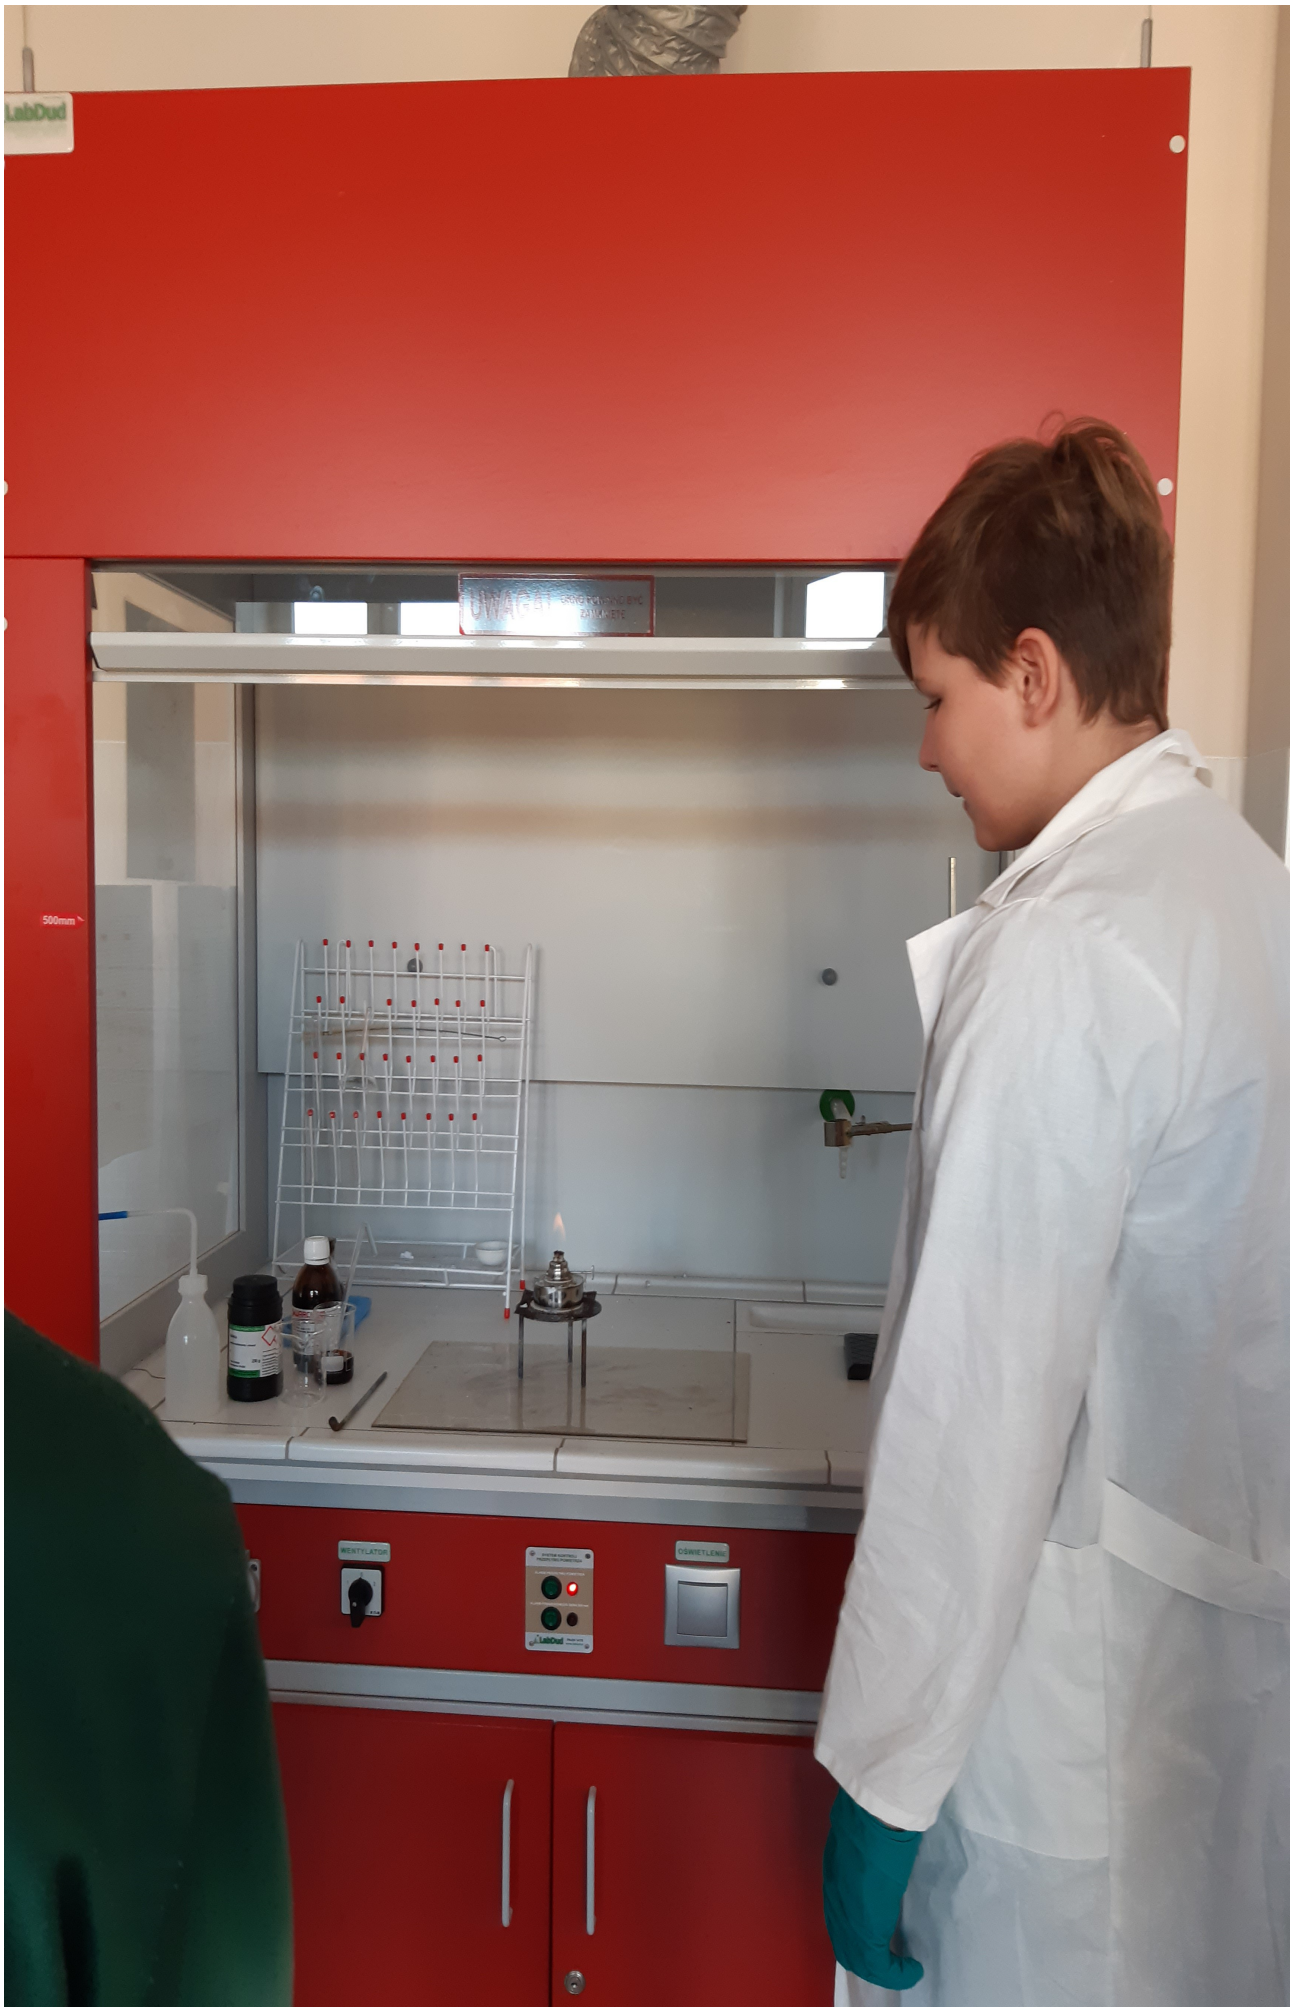





LABORATORIJ
QUALITY WEAR




MnO4+3H2O2→2MnO2+
KOH+2H2O2+3O2


LabDud
UWAGA
500mm
WENTYLATOR
OŚWIETLENIE
LabDud

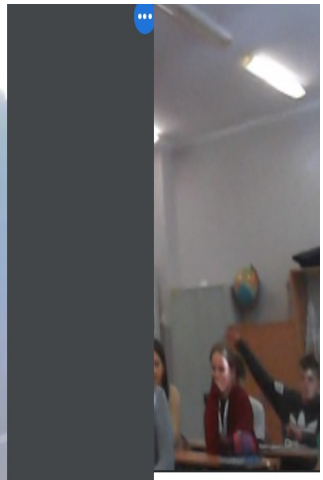





DURAN
100 ml








Ty


UWAGA